


Tecom

IMPLANTOLOGY

ed_2025_02



**BEST DENTAL
TRADING**

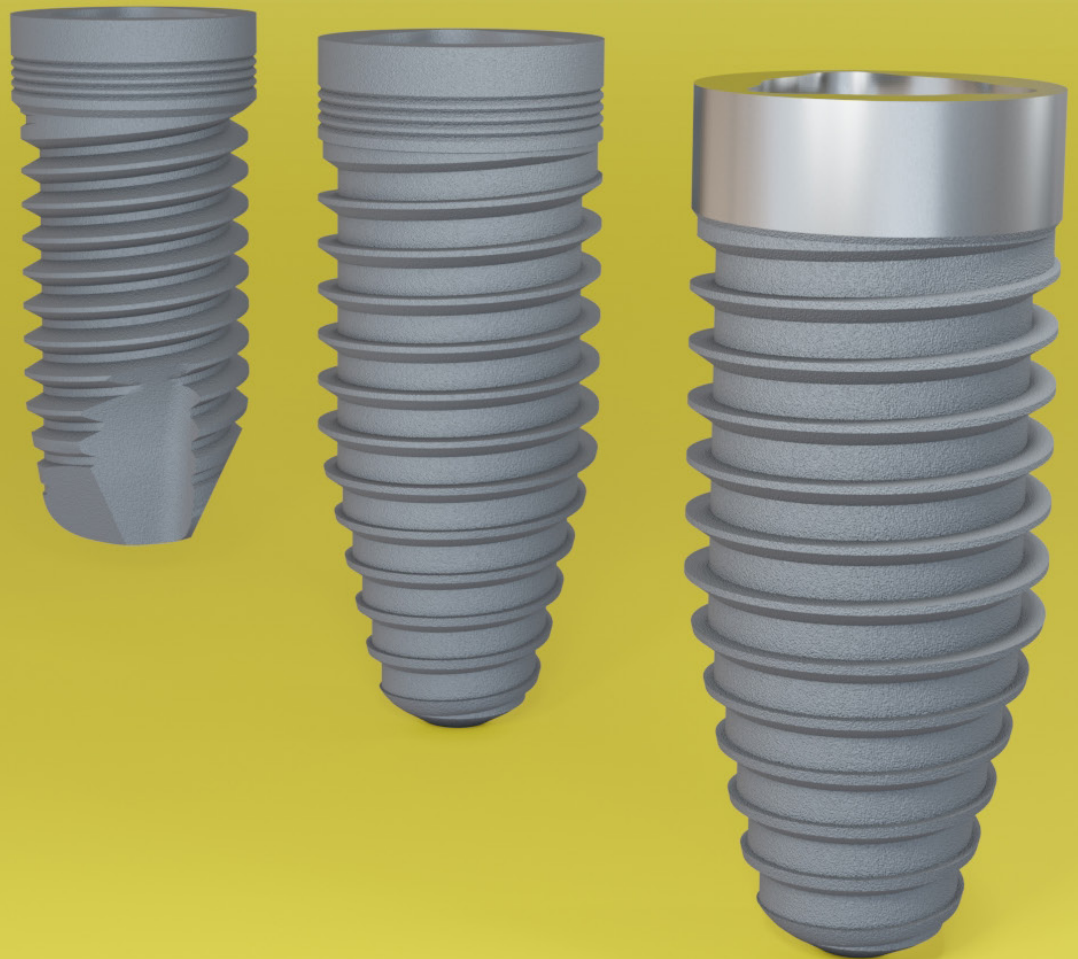

REP
Catalogo/Catalogue

Tecom

IMPLANTOLOGY

PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

CC SYSTEM	Compatibile con	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con	Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™
FRIA	Compatibile con	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®
PT	Compatibile con	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)
REP	Compatibile con	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®
STR	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®
STR BL	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.


The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers. Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

INDICE

INDEX

Caratteristiche del sistema implantare REP REPImpant system features	pag.4
Preparazione sito impantare e posizionamento impianto Implant site preparation and implant positioning	pag. 7
- Impianti - Implants	
Presca d'impronta Impression taking	pag. 10
- Componenti da laboratorio - Lab components	
Protesizzazione Prosthetic workflow	pag. 12
- Parti protesiche - Prosthetic parts	
Mua (multi unit abutment) per overdenture Mua (multi unit abutment) for overdenture	pag. 16
- MUA - MUA - Componenti da laboratorio per MUA - MUA Lab components - Parti protesiche per MUA - MUA Prosthetic parts	
Strumentario Tools	pag. 22
Condizioni generali di vendita General sale terms	pag. 27

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPIANTARE REP REP IMPLANT SYSTEM FEATURES




Sistemi implantari caratterizzati da connessione interna trilobata
Implant systems featured by tri-channel abutment connection

IMPIANTO REP TAPERED GR.To. REP GR. TU. TAPERED IMPLANT

IMPIANTO REP SEL TAPERED REP SEL TAPERED IMPLANT

Scanalature macroscopiche orizzontali
Horizontal macroscopic grooves

Collare macchinato
Machined collar

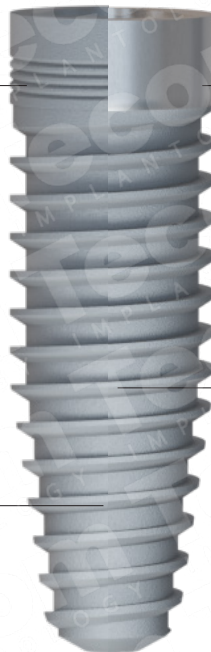


Trattamento di superficie SL Tecom
Implantology
SL Tecom Implantology surface
treatment

La parte apicale è affusolata e la parte coronale è
parallela: consente il posizionamento sia in alveoli
estrattivi che in siti guariti.

Apical part is tapered and coronal part is parallel:
allows for placement in both extraction sockets
and healed sites

IMPIANTO SPEEDY GR. TU. SPEEDY GR. TU. IMPLANT

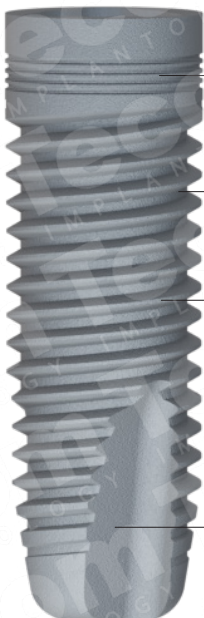

Scanalature macroscopiche orizzontali
Horizontal macroscopic grooves

Corpo cilindrico con filetto a due principi
Cylindrical body shape with two-principle threads

Trattamento di superficie SL Tecom Implantology
SL Tecom Implantology surface treatment

Forma dell'apice: piatta
Apex shape: flat

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE TIP TIP SURFACE TREATMENT

Il trattamento Titanmed SL è paragonabile ai migliori trattamenti SLA™, documentati da riviste scientifiche. È realizzato con la tecnica della sabbiatura, con una tecnologia che consente la massima coerenza del trattamento. Successivamente, la superficie viene mordenzata con soluzioni acide. La fase di sabbiatura crea una macro-ruvidità sulla superficie dell'impianto, quindi una micro-ruvidità si forma sopra di essa con il processo di mordenzatura acida. La texture della superficie che ne risulta genera una struttura adatta all'ancoraggio delle cellule osteoblastiche, favorendo l'integrazione ottimale dell'impianto con il tessuto osseo.

MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medico di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medico Grado 5. Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A. is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

VITE DI CONNESSIONE CONNECTING SCREW



Titanmed le produce con l'impronta tipo UNIGRIP™

Titanmed produces them with the UNIGRIP™ type impression


Le viti di connessione delle parti protesiche nonostante abbiano stesso filetto e impronta possono essere, a seconda del diametro dell'impianto, differenti per lunghezza totale, altezza testa, inclinazione sottotesta, ecc.

The connecting screws of the prosthetic parts have the same thread and the same imprint may be different, depending on the diameter of the implant, in terms of overall length, head height, inclination under the head, etc.

NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

IMPIANTO IMPLANT	35-45 Ncm
VITE TAPPO COVER SCREW	20 Ncm
COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS	10 Ncm
PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS	30 Ncm
MUA MUA	30 Ncm
MUA COMPONENTI DA LABORATORIO MUA LAB COMPONENTS	10 Ncm
MUA PARTI PROTESICHE MUA PROSTHETIC PARTS	20 Ncm


PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING

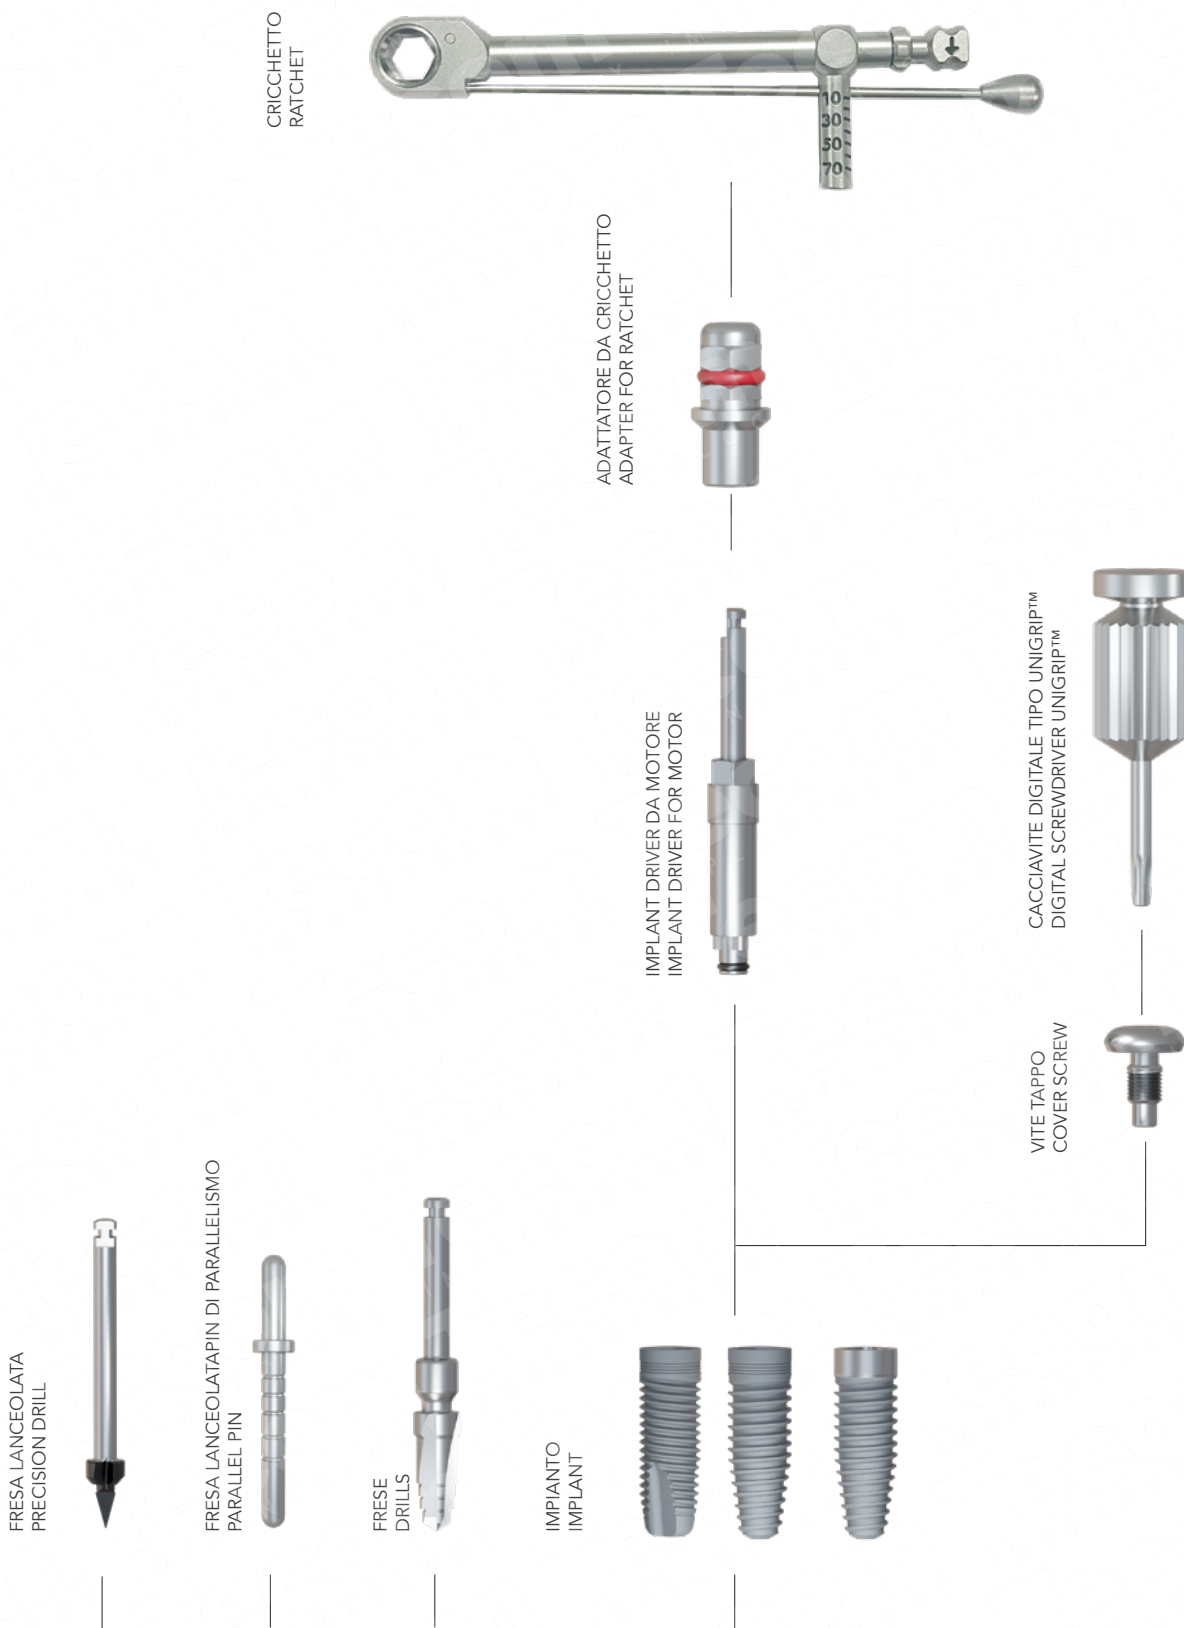


01 IMPIANTI REP TAPERED GR.TU. REP GR. TU. TAPERED IMPLANTS SYSTEM


REP


IMPIANTO REP TAPERED GR.TU. Ø3.5 REP GR. TU. TAPERED IMPLANT Ø3.5

 Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore.
Cover screw included anodized according to color code.

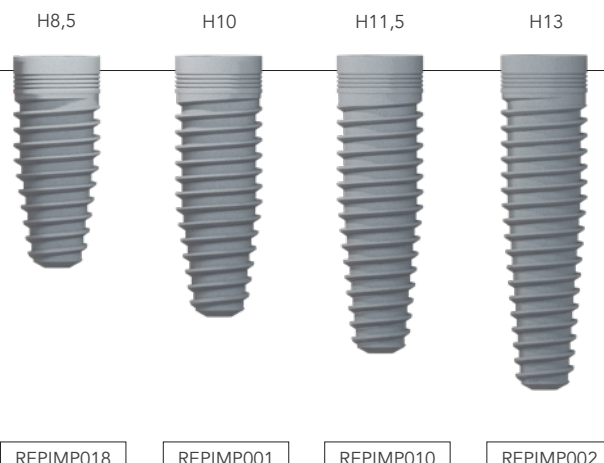


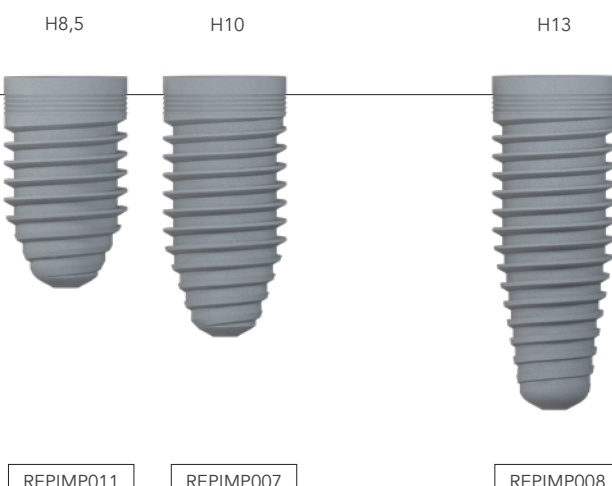
IMPIANTO REP TAPERED GR.TU. Ø4.3 REP GR. TU. TAPERED IMPLANT Ø4.3

 Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore.
Cover screw included anodized according to color code.

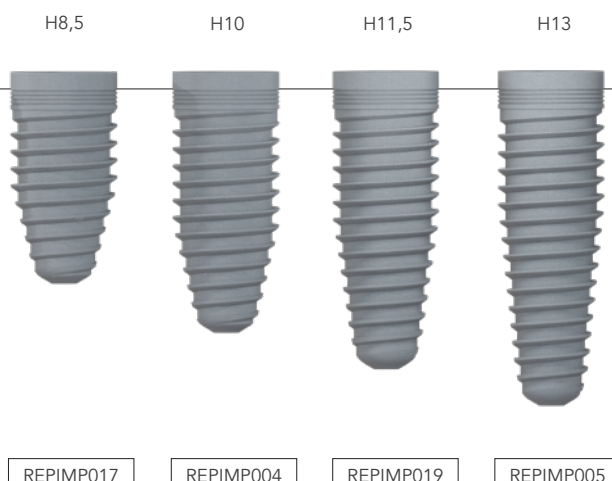

IMPIANTO REP TAPERED GR.TU. Ø5.0 REP GR. TU. TAPERED IMPLANT Ø5.0


 Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore.
Cover screw included anodized according to color code.




01 IMPIANTI REP STRAIGHT GR.TU. REP IMPLANTS SYSTEM STRAIGHT GR. TU.


REP


IMPIANTO REP STRAIGHT GR.TU. Ø3.5
REP GR. TU. STRAIGHT IMPLANT Ø3.5

 Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore.
Cover screw included anodized according to color code.

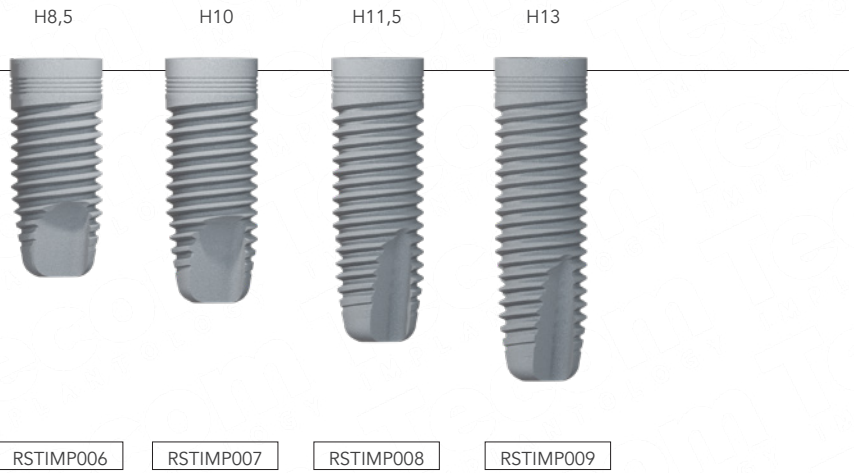


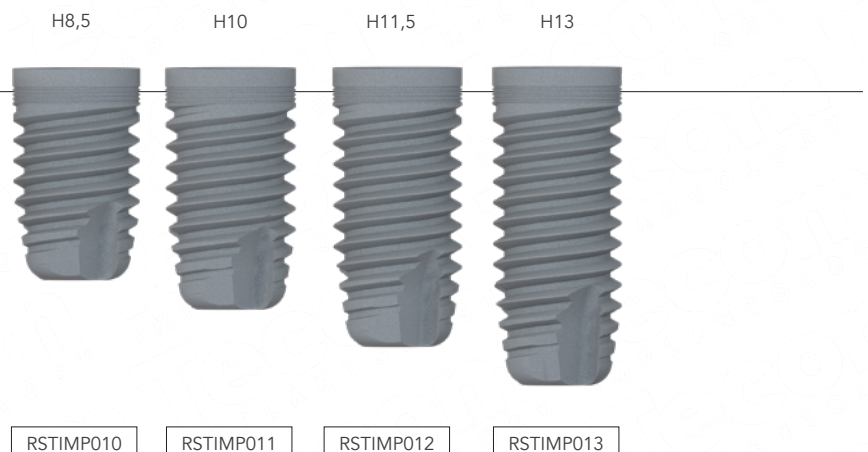
IMPIANTO REP STRAIGHT GR.TU. Ø4
REP GR. TU. STRAIGHT IMPLANT Ø4

 Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore.
Cover screw included anodized according to color code.

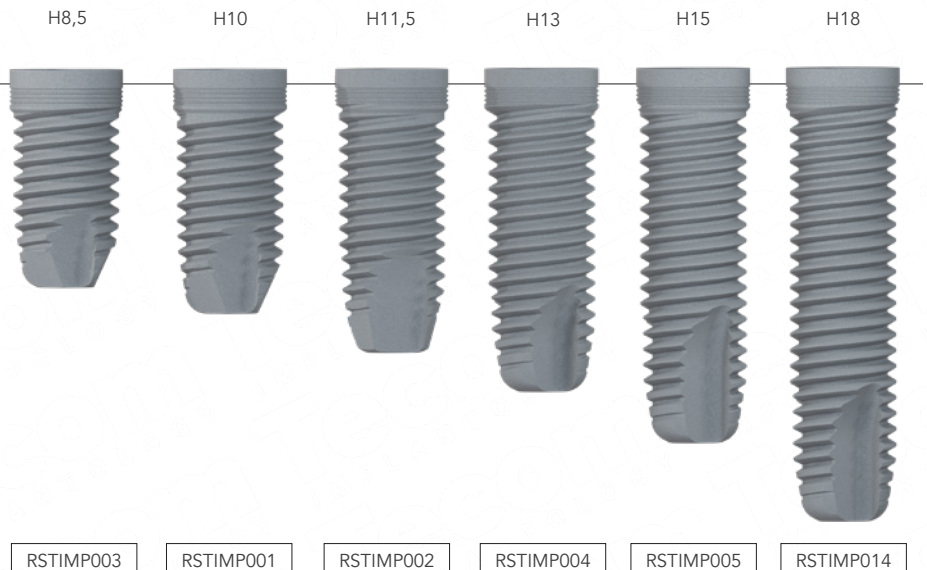

IMPIANTO REP STRAIGHT GR.TU. Ø5.0
REP GR. TU. STRAIGHT IMPLANT Ø5.0

 Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore.
Cover screw included anodized according to color code.




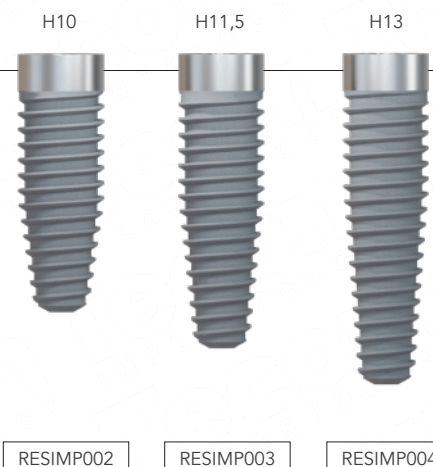
01 IMPIANTI REP SEL TAPERED

REP SEL TAPERED IMPLANTS SYSTEM

IMPIANTO REP SEL TAPERED Ø3.5


REP SEL TAPERED IMPLANT Ø3.5


 Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore.
Cover screw included anodized according to color code.



IMPIANTO REP SEL TAPERED Ø4.3


REP SEL TAPERED IMPLANT Ø4.3

 Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore.
Cover screw included anodized according to color code.

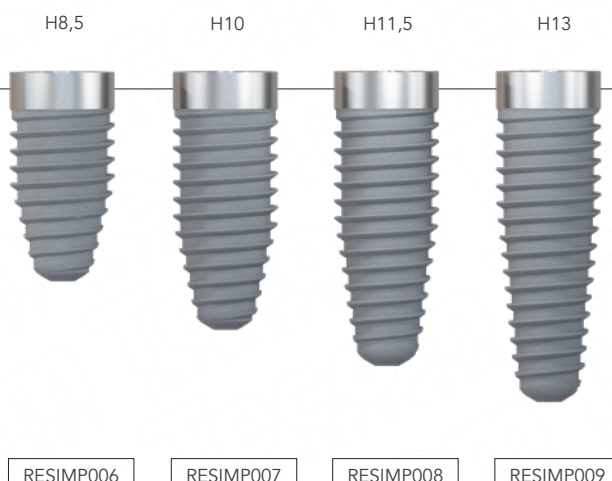


IMPIANTO REP SEL TAPERED Ø5.0

REP SEL TAPERED IMPLANT Ø5.0

 Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore.
Cover screw included anodized according to color code.



PRESA D'IMPRONTA IMPRESSION TAKING

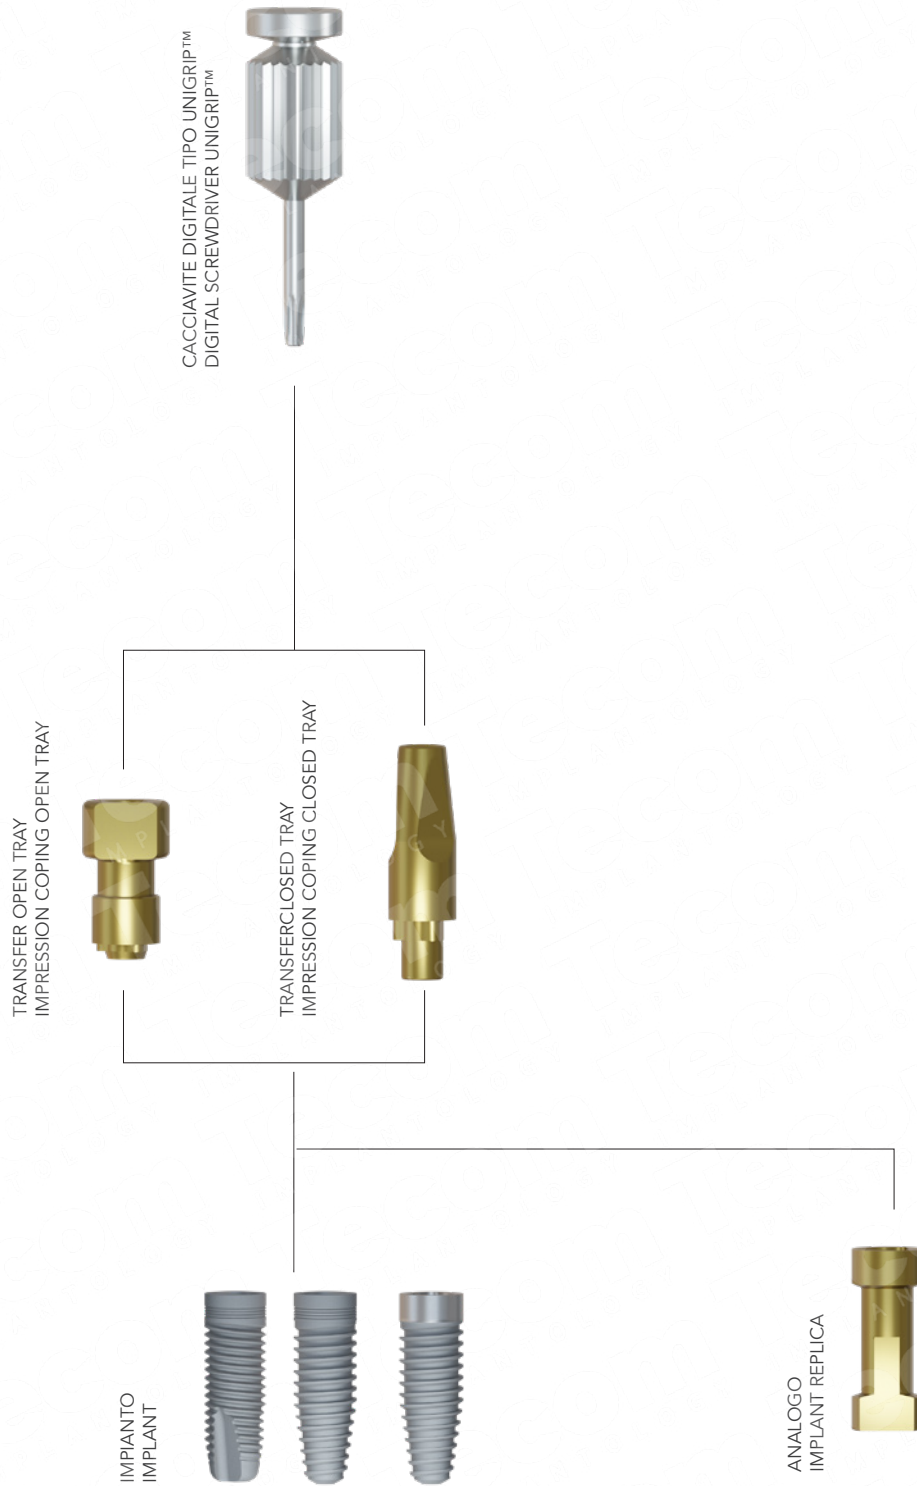

02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY IMPRESSION COPING OPEN TRAY



∅	3,5	REPPPR039
	4	REPPPR040
	4,3	REPPPR040
	5	REPPPR041

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

TRANSFER CLOSED TRAY IMPRESSION COPING CLOSED TRAY



∅	3,5	REPPPR055
	4	REPPPR056
	4,3	REPPPR056
	5	REPPPR057

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included


ANALOGO IMPLANT REPLICA



∅	3,5	REPIMP003
	4	REPIMP006
	4,3	REPIMP006
	5	REPIMP009

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

PROTESIZZAZIONE PROSTHETIC WORKFLOW

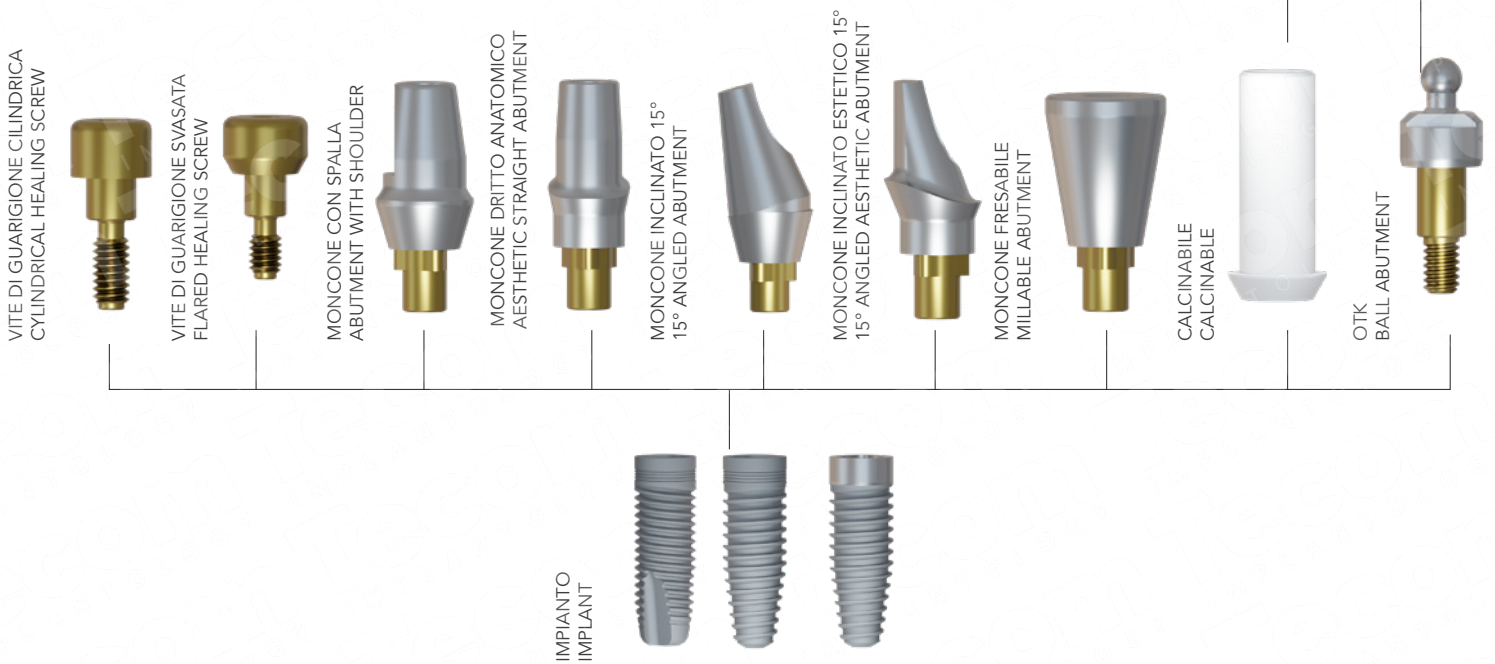

CRICCHETTO
RATCHET



ADATTATORE DA CRICCHETTO
ADAPTER FOR RATCHET



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™



DRIVER UNIGRIP™ DA MOTORE
DRIVER UNIGRIP™ FOR MOTOR



DRIVER UNIGRIP™ DA CRICCHETTO
DRIVER UNIGRIP™ FOR RATCHET



CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA
DAMPING CAP LOW OPEN



CAPPETTA AMMORTIZZO ALTA CHIUSA
DAMPING CAP TALL CLOSED



DRIVER PER OTK
DRIVER FOR OTK



03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

VITE DI GUARIGIONE CILINDRICA CYLINDRICAL HEALING SCREW



		H	
		3	5
Ø	3,5	REPVIT006	REPVIT007
	4	REPVIT010	REPVIT011
	4,3	REPVIT010	REPVIT011
	5	REPVIT026	REPVIT031

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

VITE DI GUARIGIONE SVASATA FLARED HEALING SCREW



		H	
		3	5
Ø	3,5	REPVIT003	REPVIT035
	5	REPVIT018	REPVIT034

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

MONCONE CON SPALLA ABUTMENT WITH SHOULDER



		H		
		0,5	1	3
Ø	3,5	/	REPPPR051	REPPPR046
	5	/	/	REPPPR053

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE DRITTO ANATOMICO AESTHETIC STRAIGHT ABUTMENT



		H		
		0,5	1	3
Ø	3,5	/	REPPPR073	REPPPR074
	4	/	REPPPR071	REPPPR072
	4,3	/	REPPPR071	REPPPR072
	5	REPPPR075	/	REPPPR076

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE INCLINATO 15° 15° ANGLED ABUTMENT



		H		
		0,5	1	3
Ø	3,5	/	REPPPR028	REPPPR045
	5	REPPPR063	REPPPR030	/

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE INCLINATO ESTETICO 15° 15° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT



		H	
		1	3
Ø	3,5	/	/
	4	REPPPR081	REPPPR082
	4,3	REPPPR081	REPPPR082
	5	/	/

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE FRESABILE MILLABLE ABUTMENT



Ø	3,5	REPPPR004
	4	REPPPR012
	4,3	REPPPR012
	5	REPPPR027

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE NON ROTATING CALCINABLE ABUTMENT



Ø	3,5	REPPPR002
	4	REPPPR009
	4,3	REPPPR009
	5	REPPPR025

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE CALCINABILE ROTANTE ROTATING CALCINABLE ABUTMENT



Ø	3,5	REPPPR003
	4	REPPPR010
	4,3	REPPPR010
	5	REPPPR024

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE A PALLINA (OTK)
 BALL ABUTMENT (OTK)



		H	
		1	2
Ø	3,5	REPPPR006	REPPPR044
	4	REPPPR042	REPPPR043
	4,3	REPPPR042	REPPPR043
	5	REPPPR058	REPPPR059

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA IN
 TITANIO CON O-RING
 TITANIUM DAMPING CAP LOW, OPEN WITH O-RING



BRAPPR090

O-RING CONFEZIONE 10 PZ.

O-RING 10 PCS PACK

BRAPPR105

CAPPETTA AMMORTIZZO ALTA CHIUSA IN
 TITANIO CON O-RING
 TITANIUM DAMPING CAP TALL, CLOSED WITH O-RING



BRAPPR091

O-RING CONFEZIONE 10 PZ.

O-RING 10 PCS PACK

BRAPPR105


BARRETTA DI SALDATURA (10 PZ.)
 WELDING BAR (10 PCS)



Ø	1.2	VARPPR006
	1.5	VARPPR005
	2	VARPPR004


MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) PER OVERDENTURE - POSIZIONAMENTO

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) FOR OVERDENTURE - POSITIONING

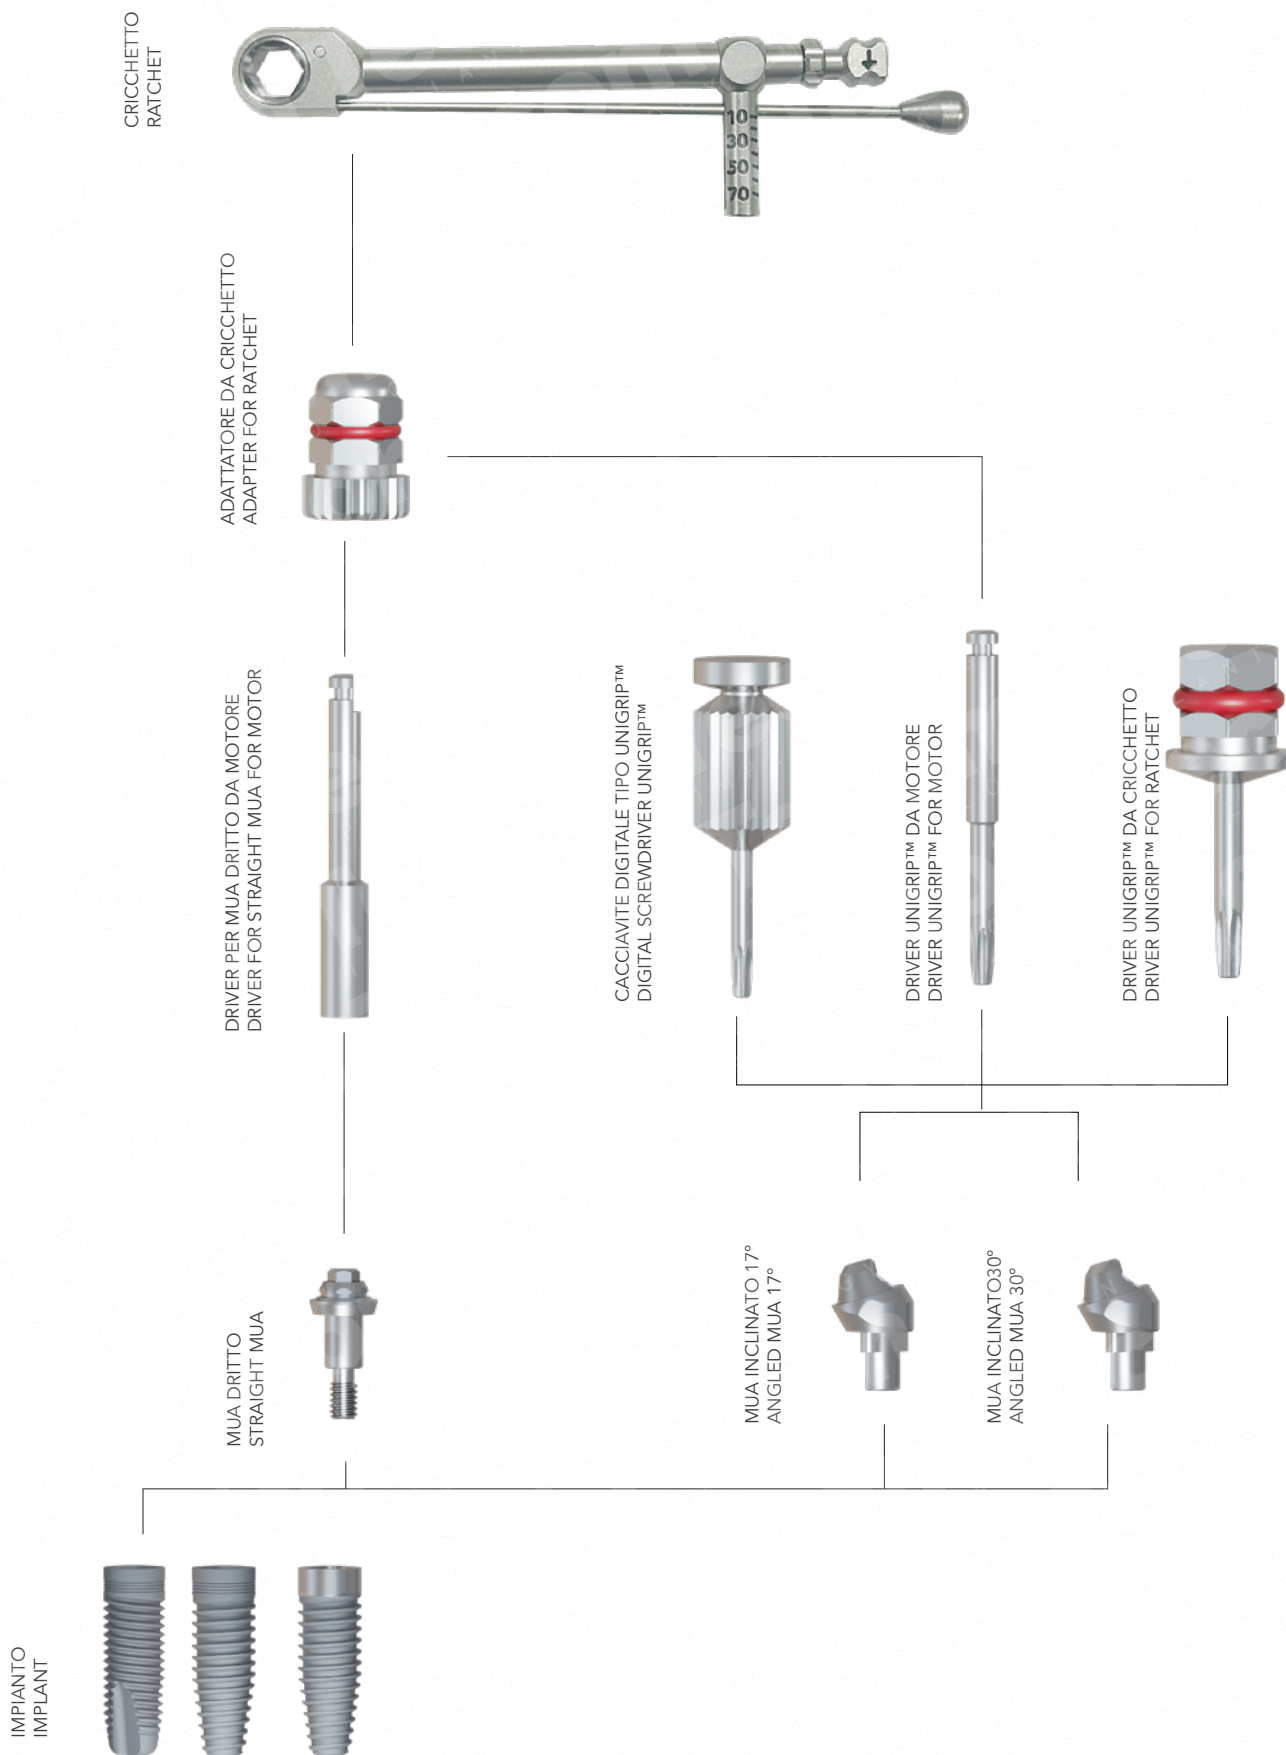


MUA PER OVERDENTURE - PRESA D'IMPRONTA

MUA FOR OVERDENTURE - IMPRESSION TAKING

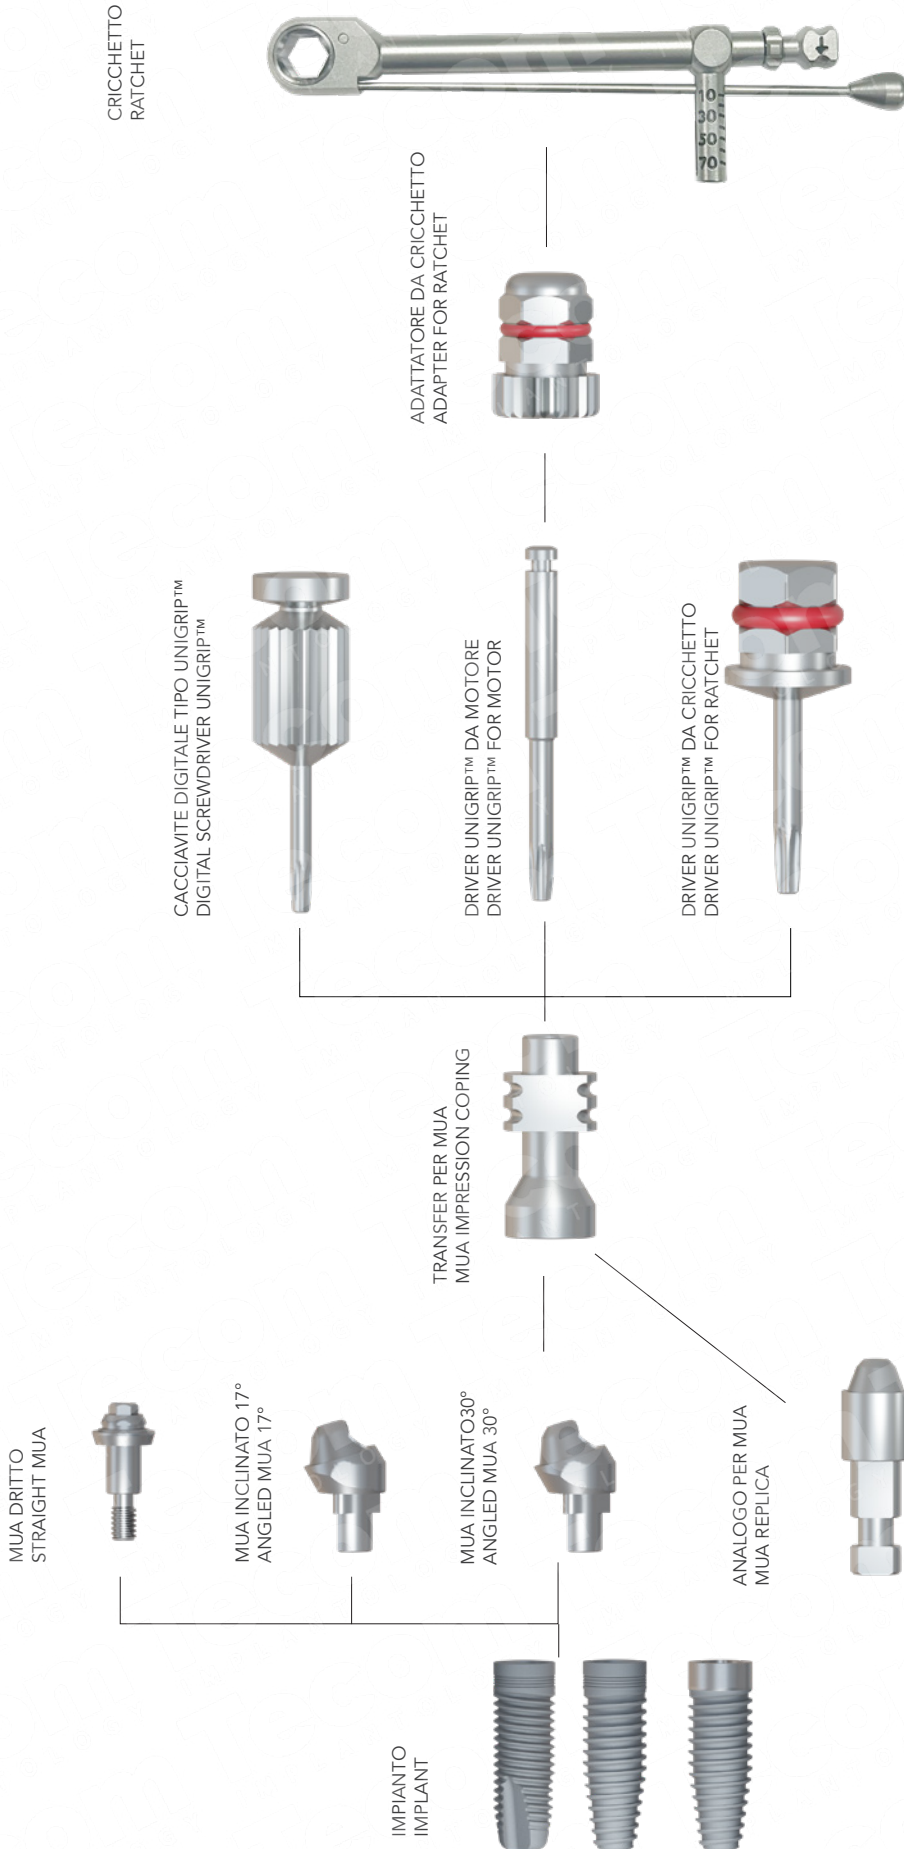

MUA PER OVERDENTURE - PROTESIZZAZIONE

MUA FOR OVERDENTURE - PROSTHETIC WORKFLOW

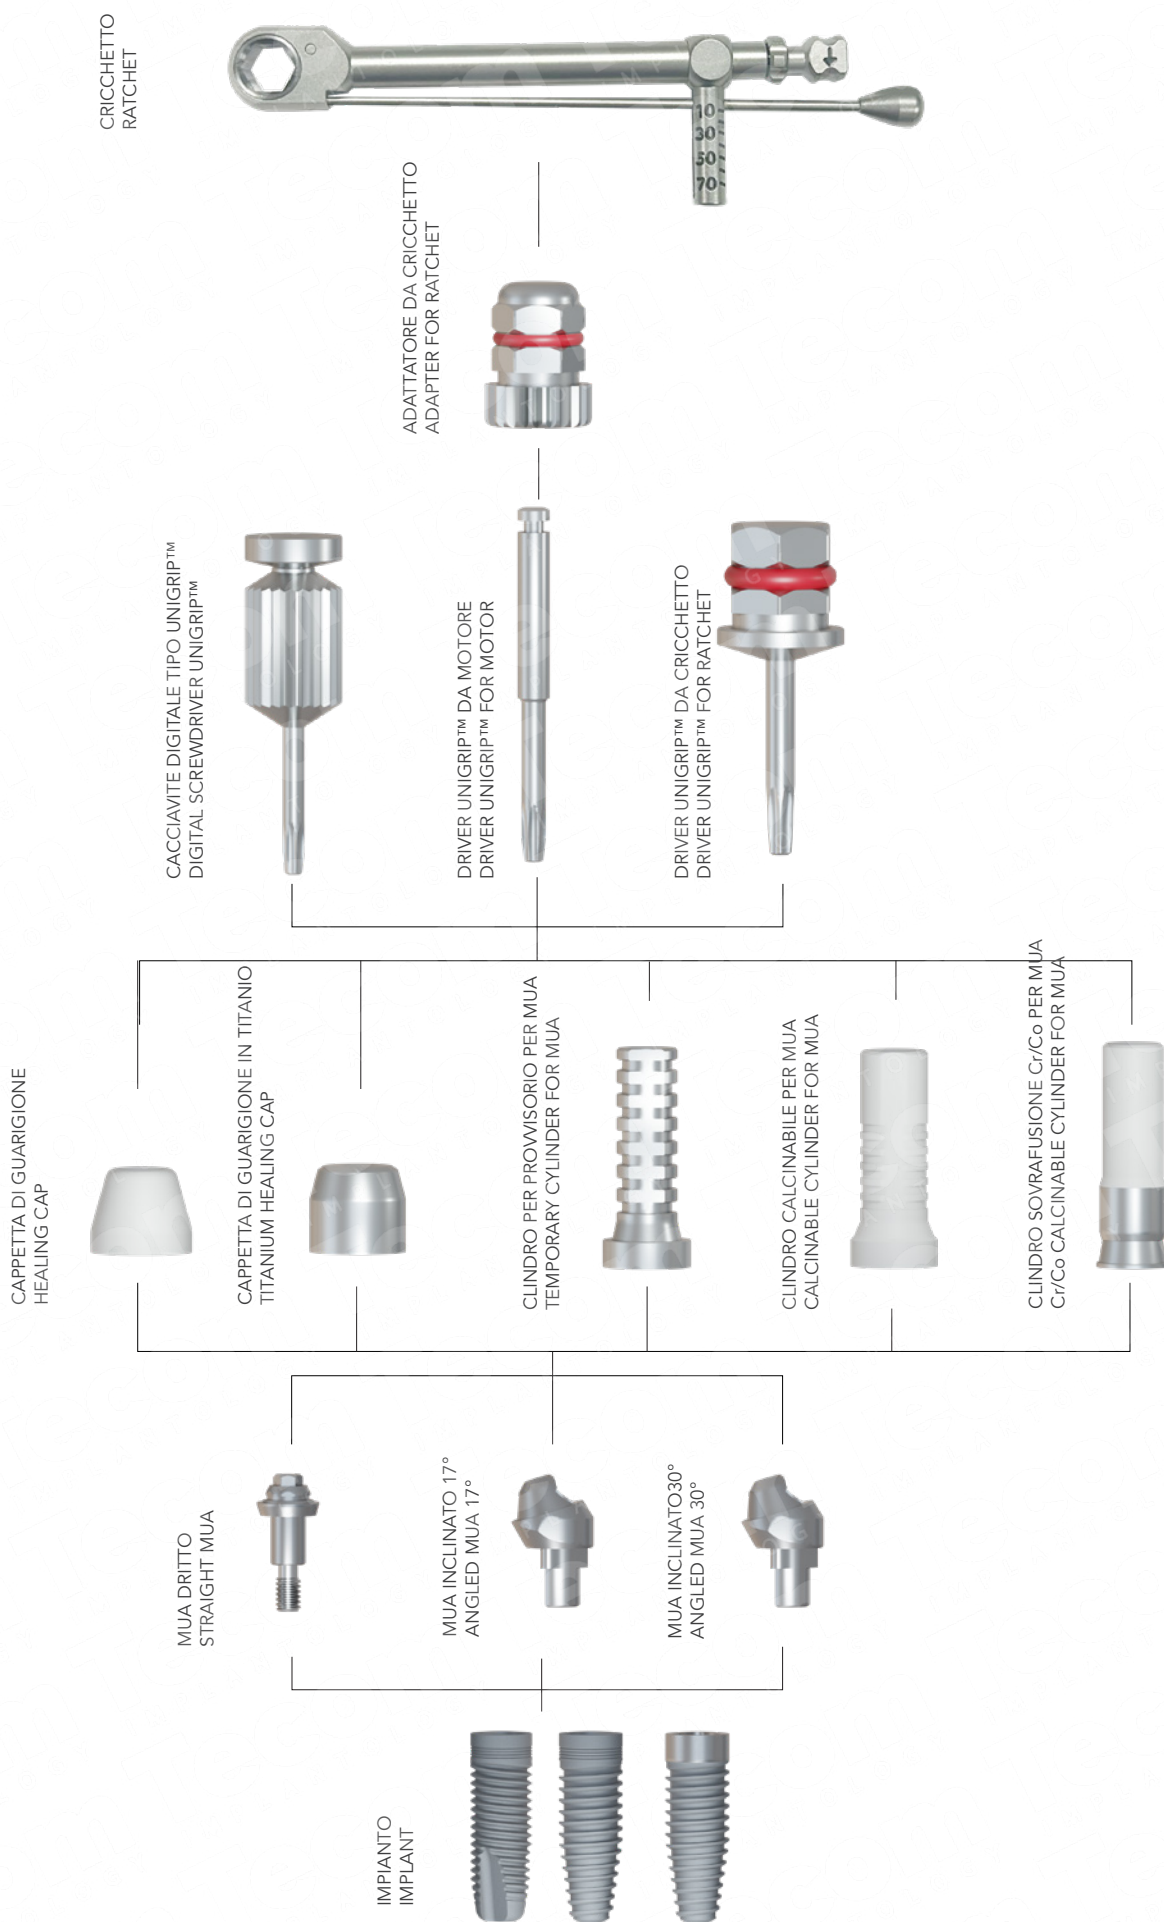

REP

04 MUA MUA

REP

MUA DRITTO STRAIGHT MUA



		H	
		1	2
Ø	3,5	REPPPR037	/
	4	REPPPR038	REPPPR047
	4,3	REPPPR038	REPPPR047

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MUA INCLINATO 17° 17° ANGLED MUA



		H	
		3	4
Ø	4	REPPPR061	REPPPR060
	4,3	REPPPR061	REPPPR060

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MUA INCLINATO 30° 30° ANGLED MUA



		H
		4
Ø	4	REPPPR062
	4,3	REPPPR062

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA MUA LAB COMPONENTS



BRAPPR087

TRANSFER PER MUA CON VITE L 15
IMPRESSION COPING FOR MUA WITH SCREW L 15

VITE DI CONNESSIONE L 20 per transfer per MUA
CONNECTING SCREW L 20 for impression coping for MUA

BRAVIT042



ANALOGO PER MUA
MUA REPLICA

BRAPPR077

06 PARTI PROTESICHE MUA MUA PROSTHETIC PARTS



CAPPETTA DI GUARIGIONE IN TITANIO PER MUA
TITANIUM HEALING CAP FOR MUA

BRAPPR141

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CAPPETTA DI GUARIGIONE PER MUA
HEALING CAP FOR MUA

BRAPPR097

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO PER PROVVISORIO PER MUA
TEMPORARY CYLINDER FOR MUA

BRAPPR086

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO SOVRAFUSIONE PER MUA Cr/Co
Cr/Co BASE FOR MUA CALCINABLE ABUTMENT

BRAPPR137

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO CALCINABILE PER MUA
CALCINABLE PLASTIC CYLINDER FOR MUA

BRAPPR108

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

07 STRUMENTARIO TOOLS



FRESA LANCEOLATA
 PRECISION DRILL

VARSTR088



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER IMPIANTI STRAIGHT PER
 OSSO MORBIDO
 DRILLING PROTOCOL FOR STRAIGHT IMPLANT FOR SOFT
 BONE

		Ø reale fresa - Real Ø drill				
		1,6	1,8	2	2,8	3
Ø	3,5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	/	/
	4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	/	/
	5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	BRASTR035



ROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER IMPIANTI STRAIGHT PER
 OSSO MEDIO
 DRILLING PROTOCOL FOR STRAIGHT IMPLANT FOR MEDIUM
 BONE

		Ø reale fresa - Real Ø drill							
		1,6	1,8	2	2,8	3	3,25	3,4	3,55
Ø	3,5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	/	/	/
	4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	BRASTR036	/	/
	5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	/	/	BRASTR038



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER IMPIANTI STRAIGHT PER
 OSSO DURO
 DRILLING PROTOCOL FOR STRAIGHT IMPLANT FOR DENSE
 BONE

		Ø reale fresa - Real Ø drill						
		1,6	1,8	2	2,8	3,4	3,55	4,25
Ø	3,5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	/	/
	4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	RSTSTR001	/	/
	5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	BRASTR038	BRASTR037



FRESE PILOTA PER IMPIANTI TAPERED PILOT DRILLS FOR TAPERED IMPLANT

		Ø reale fresa - Real Ø drill		
		1,6	1,8	2
Ø	3,5	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009
	4,3	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009
	5	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009



PIN DI PARALLELISMO PARALLEL PIN

Ø	2/2,7	SF0STR122
---	-------	-----------

Dotato di tacche di profondità per impianti H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

Depth indicator for implants H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER IMPIANTI TAPERED PER TUTTI I TIPI DI OSSO DRILLING PROTOCOL FOR TAPERED IMPLANT FOR ALL BONES

		Lunghezza impianto - Implant length			
		8	10	11,5	13
Ø	3,5	REPSTR016	REPSTR038	REPSTR036	REPSTR018
	4,3	REPSTR019	REPSTR039	REPSTR037	REPSTR021
	5	REPSTR022	REPSTR023	REPSTR050	REPSTR024



IMPLANT DRIVER DA MOTORE IMPLANT DRIVER FOR MOTOR

		L	
		5	14
Ø	3,5	REPSTR025	REPSTR026
	4	REPSTR027	REPSTR028
	4,3	REPSTR027	REPSTR028
	5	REPSTR029	REPSTR030

ADATTATORE DA CRICCHETTO PER IMPLANT DRIVER ADAPTER FOR RATCHET FOR IMPLANT DRIVER



VARSTR086

Consente di utilizzare gli implant driver da motore con i cricchetti Titanmed
This adapter allows to use the implant drivers for motor with Titanmed ratchets

CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™ DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™ TYPE



L	
12	17
BRASTR004	BRASTR015

DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA MOTORE DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR MOTOR



L	
26	32
BRASTR001	BRASTR027

ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS



VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titanmed
This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA CRICCHETTO
DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR RATCHET

L	
12	17
BRASTR057	BRASTR058

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets



CACCIAVITE DIGITALE PER OTK
DIGITAL SCREWDRIVER FOR OTK

BRASTR003



DRIVER PER OTK DA MOTORE
DRIVER FOR OTK FOR MOTOR

L
20
BRASTR014



DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE
DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR

L
25
BRASTR046



CRICCHETTO DINAMOMETRICO TITANMED
DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET

VARSTR089



CRICCHETTO FISSO TITANMED
FIXED TITANMED RATCHET

VARSTR069



CACCIAVITE MANUALE PER STRUMENTI A CRICCHETTO
MANUAL SCREWDRIVER FOR RATCHETS INSTRUMENTS

L

170

VARSTR085

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



PROLUNGA PER FRESE
DRILL EXTENDER

VARSTR032

08 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE TERMS

VALIDITÀ Il presente listino è l'Ed.2024_01 e sostituisce le edizioni precedenti.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d'ora in poi anche "Titanmed") e gli altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Titanmed, seguendo le istruzioni contenute nelle confezioni. L'uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, comporta la decadenza della garanzia e l'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda Titanmed. I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come un'alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell'utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi medicali Titanmed deve accertare l'idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti. Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell'applicazione pratica o nell'inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed. Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di non procedere all'acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni e/o illustrazioni.

COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORDINI Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità:

TELEFONO: 0039 0341 363504

lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: ordini@tecomimplantology.com

SPEDIZIONE DEL MATERIALE Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all'indirizzo indicato dall'acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

RESO DEL MATERIALE Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta.

Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l'avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all'acquirente, addebitandogli le spese di spedizione.

MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

VALIDITY This pricelist is the Ed.2024_01 and replaces any previous editions.

EXCLUSION OF RESPONSIBILITY The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also "Titanmed") and other Titanmed medical devices may be used only with original Titanmed components and instruments, following the instructions provided inside the package. The use of devices manufactured by other companies or manufactured by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or implicit obligation of Titanmed. The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to the user's training and professional experience.

The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed medical devices.

Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions and/or illustrations.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form. Third-party brands, product names, trademarks and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrate Titanmed's product features, without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 196/2003.

ORDER PLACEMENT Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and desired quantity, in the following ways:

TELEPHONE: 0039 (0)341 363504

Monday – Friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: export@tecomimplantology.com

PRODUCT SHIPMENTS Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

RETURNED MATERIALS The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from the products delivery date and must be pre-authorized by Titanmed in writing.

The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for transportation.

If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES Titanmed reserves the right to make changes to the products contained in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).



CONTACTS

CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia



leveres i Norge av:
Best Dental Trading

Tel: 75 64 65 66
Email: bestdental@bestdental.no

Titanmed

Leading to perfection

www.titanmed.it
www.tecomimplantology.com